

NOUVEAUX NODULES SOLIDES ET SUBSOLIDES


Dépistage négatif

Risque très faible
volume (composante) solide < 30mm³
(diamètre < 4mm)

Dépistage indéterminé

Risque intermédiaire
volume (composante) solide $\geq 30\text{mm}^3$
(diamètre $\geq 4\text{mm}$)

Dépistage positif

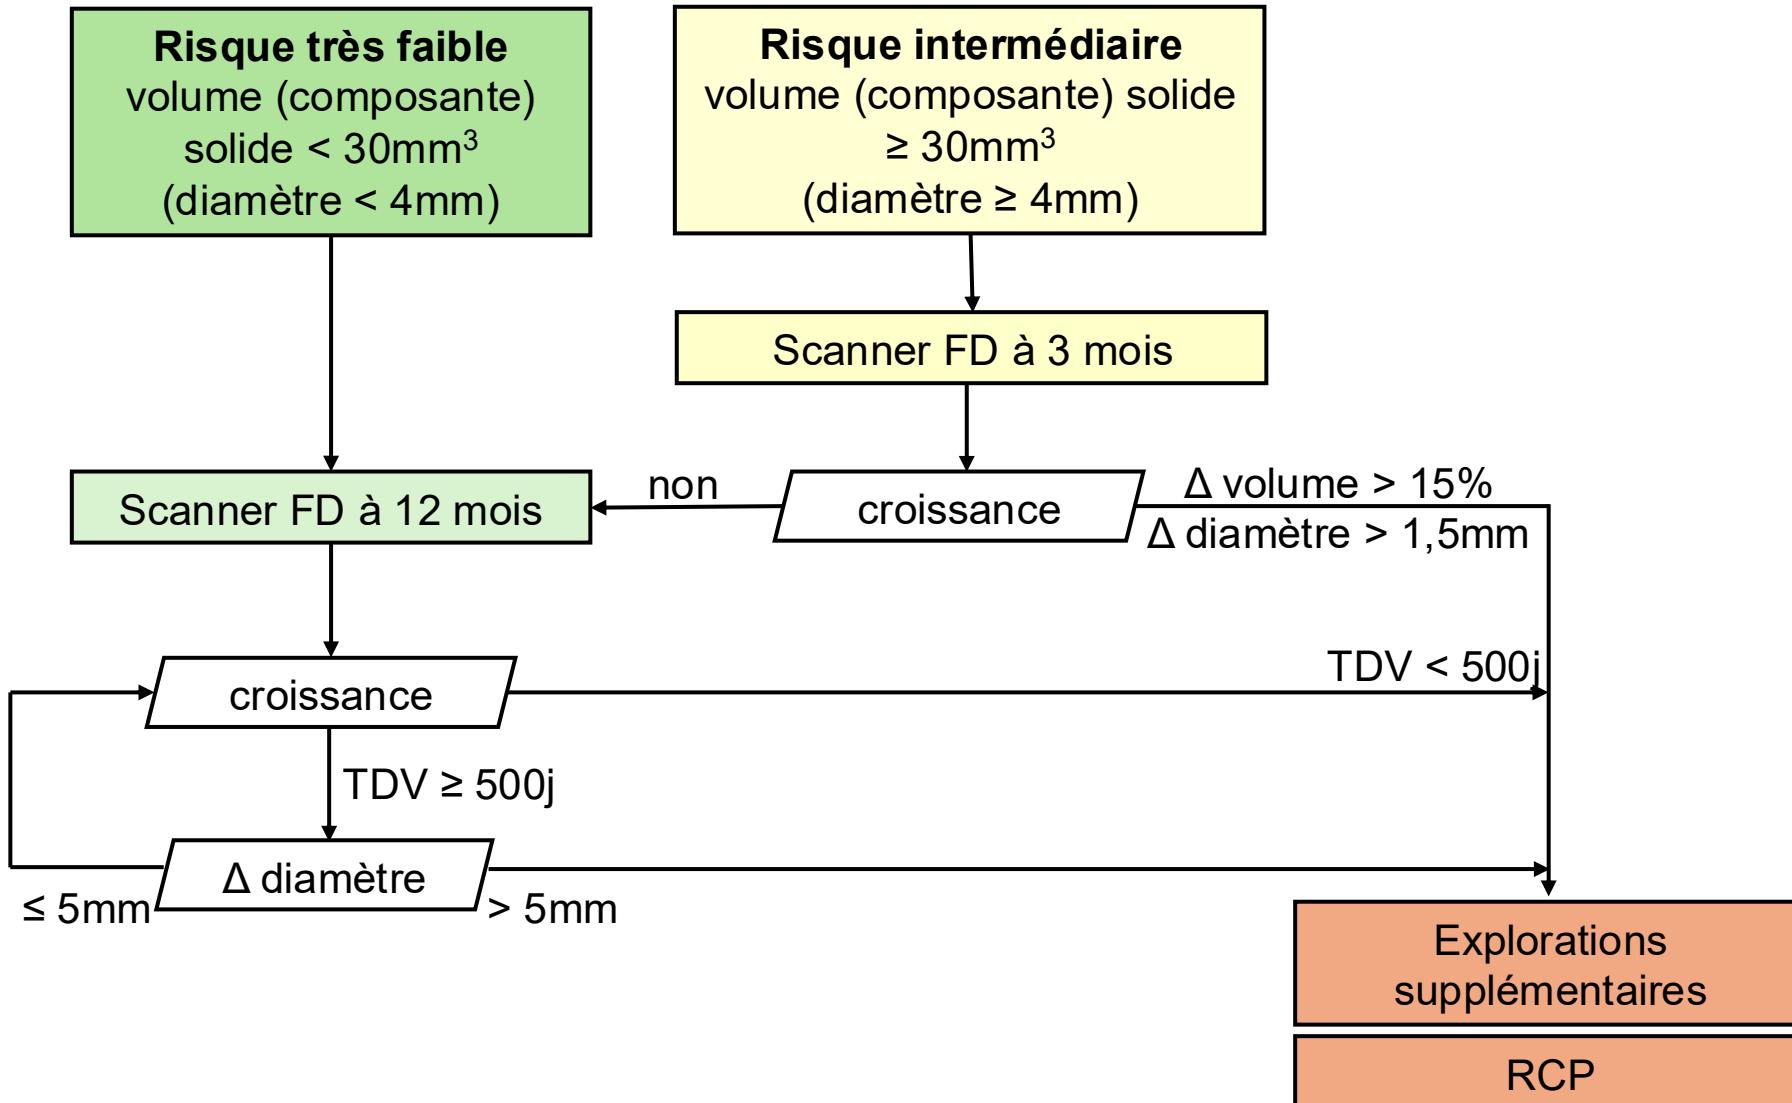

FD: faible dose, TDV: temps de doublement de volume, j: jours